

h6ö oc N9@B RP =A8

d- ü fl ö d-µ äyffi öB- P |ä-ffü - ffb-ffi

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de


h6ö oc fly ffi - d±β±flfl- h6- ±o ± fl± fl-yö RNh5c ffb· β |µß- fl- -ffi yö
 Xfi yöy ±ffi fffl± ö± ffb· µß- ffid- ü fl ö ffflüy β-- ß-j-ffi yffi|µö -z-ffi ß-ffR±
 ü fl öy -ffR×5 |µ±ffi fffü ffi± zy -ffU-µ - fl- h6ö oc5g fl ä - öy -ffi ±µ-ffiy|µ
 yüü -ffi -|ä-ffi fffl- öy z-ffi -ff |µffiöj -ü- -±- ffbR± - zö4fl- -ffi yö m- -ß ffb
 - öy z fl± ±- fffl fffµ ffi± - Ry -ffi ·y ffb ffyµ- yü Ü -ß-ffid- ffaß - -j-ffi Sbyz-ö
 · µ-ffi -ff ß- ffb- -ffj yffi öBä-±6

- ij@DAT-ßlz 5|µffi -ö z± @Ddz Fc |yP 4 ■ Söä üyßffi ±|µ- m- ßäµä-±ß-ü SeB98885@ ffflSeAA899
- Nffi|µö zy yffyö Q ffi ö h6 y ±ffio ■ j yfffi ffb - ß ffb98 6=8 mRQ
- d ffyß- y · k yß |µ±ffi ÖeB8C9A1




S3µ FF 3 µü Uµz µ

- Wffffz µü¹ µS³ zß 3µ ü°
: @sz±NRQ498 äv Nz y y - byffyö
- I³ üzäffü¹³ fffü 3µ ü°
cffi y ±± ffb4flß±yö Tß- 4d ± -ö - 4j äyö ffb4d fff7dy 5j -±µ- 4 N ±µü - ß4Nöy ü
- T3ü°µfiz µ l² ü 4p 3µ zü¹
jµ ffi5 z- · ffbfl- ß- yü -ffid- ä- -6
- 8C Oüzffµ T3ü°zü° Üzü ä± Sµ² üö µ µ³µü
9B-|µ- y yöö- SffB ffb-4ä-ffid ö±ö -
- TäüÜ ffb z°üµ³ ffµc ffb Özfiß /Te R0
ß-ü XQ B98885@ ffflSe AA899
- Vzäzü³ ffµmµüü ü°
byffyö m- ß ffb j|µffi -ö
- O² äiz µT3ü°zü° 4µ µffµ± ffb 3 zäµ I³ üzäkkz ff4
om² äü³
: fl- :8 ü m7m0 @888 ü 7ü fl- @8888 ü 7ü ü ±äl :1

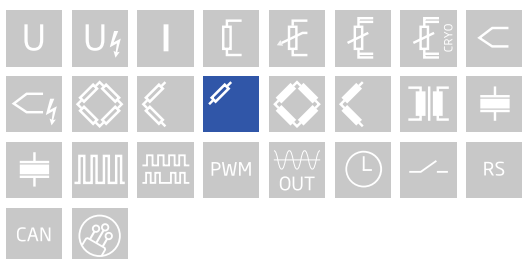


Päffü z° zö ö

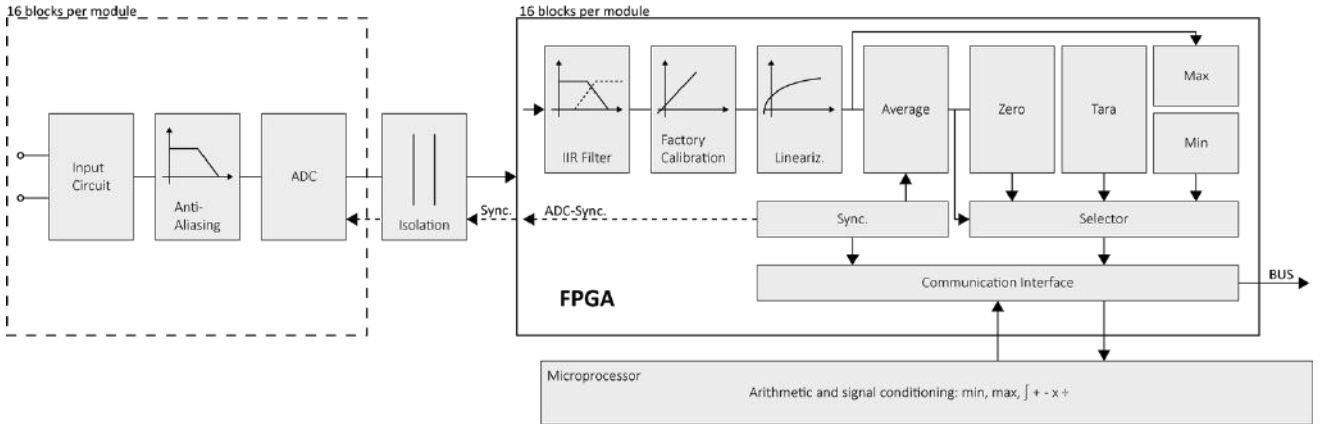

müff ü³ ff µ Sz mü

Nffi | mü z-ö-ß ffb RP: BVR

A _{in} 1	U _{sig} 17	A _{in} 5	U _{sig} 13
U _{Exc+} 8	U _{Exc+} 4	U _{Exc+} 4	U _{Exc+} 4
U _{Exc-} 26	U _{Exc-} 22	U _{Exc-} 22	U _{Exc-} 22
A _{in} 2	U _{sig} 16	A _{in} 6	U _{sig} 12
U _{Exc+} 7	U _{Exc+} 3	U _{Exc+} 3	U _{Exc+} 3
U _{Exc-} 25	U _{Exc-} 21	U _{Exc-} 21	U _{Exc-} 21
A _{in} 3	U _{sig} 15	A _{in} 7	U _{sig} 11
U _{Exc+} 6	U _{Exc+} 2	U _{Exc+} 2	U _{Exc+} 2
U _{Exc-} 24	U _{Exc-} 20	U _{Exc-} 20	U _{Exc-} 20
A _{in} 4	U _{sig} 14	A _{in} 8	U _{sig} 10
U _{Exc+} 5	U _{Exc+} 1	U _{Exc+} 1	U _{Exc+} 1
U _{Exc-} 23	U _{Exc-} 19	U _{Exc-} 19	U _{Exc-} 19
A _{in} 9	U _{sig} 17	A _{in} 13	U _{sig} 13
U _{Exc+} 8	U _{Exc+} 4	U _{Exc+} 4	U _{Exc+} 4
U _{Exc-} 26	U _{Exc-} 22	U _{Exc-} 22	U _{Exc-} 22
A _{in} 10	U _{sig} 16	A _{in} 14	U _{sig} 12
U _{Exc+} 7	U _{Exc+} 3	U _{Exc+} 3	U _{Exc+} 3
U _{Exc-} 25	U _{Exc-} 21	U _{Exc-} 21	U _{Exc-} 21
A _{in} 11	U _{sig} 15	A _{in} 15	U _{sig} 11
U _{Exc+} 6	U _{Exc+} 2	U _{Exc+} 2	U _{Exc+} 2
U _{Exc-} 24	U _{Exc-} 20	U _{Exc-} 20	U _{Exc-} 20
A _{in} 12	U _{sig} 14	A _{in} 16	U _{sig} 10
U _{Exc+} 5	U _{Exc+} 1	U _{Exc+} 1	U _{Exc+} 1
U _{Exc-} 23	U _{Exc-} 19	U _{Exc-} 19	U _{Exc-} 19

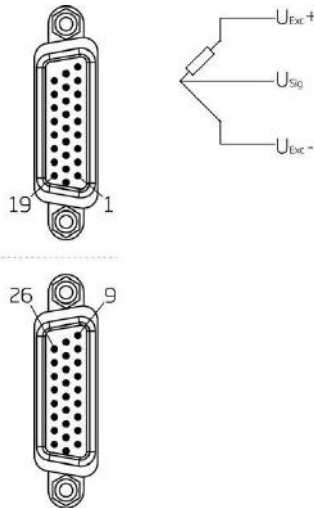

Nffyö B- S-ffb ffb-

Oü z² ä	8C
Vµüz ³ Üµ³	759, Ω³ ff
	75B, ü fµ² µ ff µ ö z° üµ³ ff µ nó ° µfi ü°
	75B, ³ ü¹ ³ äüü Pµ µ³ ff
düµz³ zfi µ³ ff ü°	758, ff Tü¹ µ Ω³ ff
Tü°zü° ³ µ zü¹	l 87 e
a ffb ³ ffü Ωzüü ü°	B77 oSRczüzä ffoµ ffi° ü° Ωzüü ü° ffi ffü³ mü

9 - ffi -|µ-ffi Se B9=: B: 88BF5 B ffi ffb P
 = - ffi -|µ-ffi Se B9=: B: 88BF5 B ffi ffb N
 = j yffffi ffb-ffz± 9888 mRQ4fly - µy· z± : AB mRQ

h6ö oc N9@B RP =A8

d- ü fl ö d-µ äyffi öB- P |ä-ffü - ffb-ffi

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de



Nffjö B7R-B±yö ü - ffb

O ü°	9A4fi³
p zü¹ µäz µ	87 ÜW Ω ffc züzä
p zü¹ µä µ ±² µü	³ ö z4 µäz
Oü ³ä³z ³ü° äµ	8ÜW 3< ¹ g ¹ü ü°
S³³ zäµ äµ	äü ü³ µäö Ω äµkµ Ωffü µ/akÖmµ±Öz 3WffFÖz 3Pzü¹Ω 3Pzü¹ ffbP µ ffi² ffiµ Pµ µä /9ü¹ 3A² 3C² ffiµ E² g¹ü ü° ÖU µ mü fiµ µFF 75B fi³ 9ÜW
e³ µä µ fi³ ü°	Üffü ° ³µ fiz ffiµ z ffö z³ ff µü Ω µff µü¹ µ °µ² äµü Sz µü z µ

d- y P |ä-

P flÜµüz	p³ µ zü¹ o³µ µäfi flÜµ /<4dµ³ µ 3ö³ czfiµä³ü	Üffö Ωµü z ³ffü0
Vµüz ³Üµ³ Üz µ	75B	
P flÜµüµ ° ü ü° ³µ zü¹	<87 /zü¹ µ µz ±0ü±z° µ0	
µjö ÖSRffµ ffµü ffkµ³ züflµ /mRk0	75B Ωö 6c	
T³ü° zü° fiµ µFF² ³fiz	9ö o6o	97 ö o6o
Vµüz ³Üµ³	75B,	75B,
l² ü p³ µ zü¹	877 Ü ³ü µ üµ p³ µ zü¹	
P flÜµü Ωµ³ ü°	9oSRΩ ffc züzä	
e z ³ ö l µü ffiÜzfiµä ü° µ	8B7 ö	
dzü° µ³ zfi³	l 75B o6o 69A²	l 9 o6o 6E777²
µjö Ωµ z ¹ ±	l 75B o6o 687 c 0 ±f äÖ üÜ	75B, 687 c 0 ±e µ µö Ω ü¹ ³FF Üµ³
kz ff µü	l 75c o6o /fiµ³ 87 W 0	

b ü ü ffiäy ± ffi |µffz -ö c |yä

h ffi flÜffü	h ffö ³µ µ dffflz³P /88B977 fiΩ fi³ AE e fiΩ 3dz µü l 877 ü 0 Ol Ræ/8F977 fiΩ fi³ 88B977 fiΩ 0 e ffi fi km
Sz µü ³ffü z	ET8
l zü¹ z¹	Of l ämÖ6Tä04AEB40394³ µ

m- B ffb

oµ ffi° ü° Ωzüü ü°	87 fi³ <7oSR3 fiµ Ωzüü ü° 4 ü¹ oµ Öffä ü° ff
dµ³ ü° z ±iz² ö µ	9p /fl5D
l Ωzüü ü° µ³ü	l 7578, 6o

l ü B-z ffb z-fl-ffb ffb-ffi

TäüÜ ffö z° üµ³ ff µoµ ° ³FF Üµ³ /Te RO	µü Ω µff µü¹ äRC87774A ü¹ Tf BB788
Pµ ³µfi µö Ωµ z	497 R fi³ 2C7 R
dz° µ µö Ωµ z	4A7 R fi³ 2EB R
kµä³ µä ± ³µ ff ³Üµ³	B4FB, fiµ³ B7 R/ü³FF Üffü¹ µü ³µ µü¹ 0

U ö-Bä-± fl- Nffßyz-ffi

Oäµ Oü° zfiµü ³ü¹ ° ä³ üzff µ³µ 0 ± ö µ³ ffi ABe ³ü mü
 µff µü³ ff µ ü¹ µ ü° µü ffiµ² zä µü

h6ö oc N9@B RP =A8

d- ü fl ö d-µ äyffi öß- P |ä-ffü - ffb-ffi

d-|µyffi±|µ- Xfi ü y ± ffi ffi

ez µ žä	Oä ö ü³ ö ü¹ OPI
Ofiö µ ü°µü/P W m0	<7 8AB 8<Bö ö
Vµ žP	fz5B77 °
I fP Üž µ	h97

P- -ö ffb Xfi ü y ± ffi ffi

O üäi ö ö µ	DDDC <B
-------------	---------

Uyffi ffi ü -ffi

N ž U- üyffi Tyffi- j -fl-ffi Xfiy I j N Quffy j fby -
d ffiy ffi y -@ NSBCD8 j |µ ffi k 3@-AAAB CC @B=5B
j -ffi- -fi- j @ R5B=998 i fißy k 3@E B98B BB88D5B

Vertrieb durch 

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

