


effi | gfi füz N9: DAPj


az ° öy ı ffıfız Oz fı ° ä' öä z ıß ffıxfızä Zzfl ä' zä

Müxıyıvfıü² ²

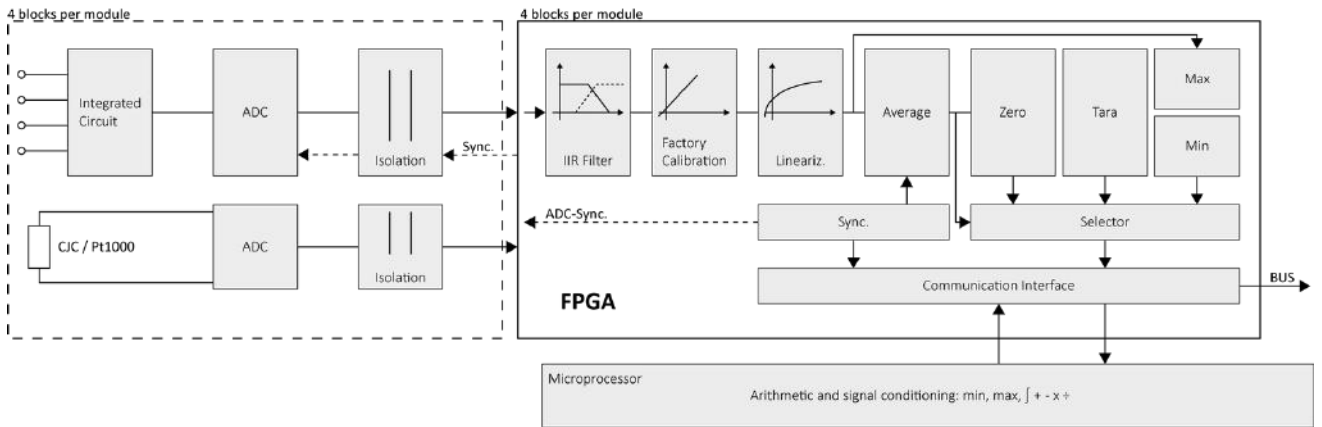

hzxfı³ ffxflz OvΩ³

Nä xfi± wııı' ä' Uöxfı üvää ä' Oväváz ı Qg wııı° vııı

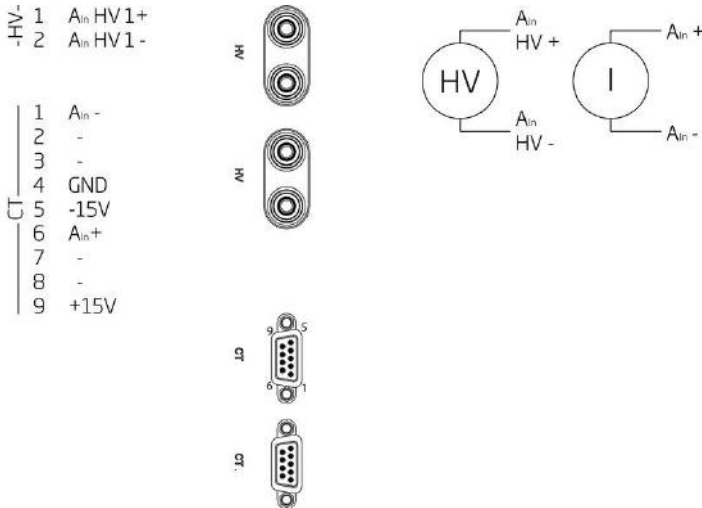

Nävı' z Rfıä' ä' z

L³ vfi°	B
Sı³ v fııııı	647 + Ω ä ffxfl
	648 < + ı³ wıfız üffıfıfıü² vfi³ z Qffıfıfıüı² fıız ı³ fı
	64 < + ı² ı³ y ffıfız °ı³ Mıüz ııfı
Xı³ z vııı° Qffıw z ııfı ı³ fı	647 + Ü² Pı³ y z üüü ä ffxfl
I ızyz üfıüüü ffxü³	6469 + Ω ä ffxfl. ı³ ı³ zıfıvıw8: fı/
üfıvıü³ fıııvı³ ı³ fı	7866 kONyv zıfıvıQWı³ v° Wı³ v° ügävı³ ı³ fıff zıfıüfı ı³ fı ügxflı³ Qffıfı z

ı³ zä üffıxfızäy Rb C9@ C: 88CRfı ä ä' O
 : zä üffıxfızäy Rb C9@ C: 88CRfı ä ä' N
 © Uöxfı üvää ä' ııwä yv zffıQO0 Ra öyz ııızfı fı zııı° °' ffxızä |zıfıfıvıvıvıfı wıfıı 88j QP äy C8 Pıv zffıv|

effi | gfi fäz N9: DAPj

az ° öy ð ffyz Oz fi ° ä' öä z±ß fflxfizä Zzfl ä' zä

az vffigüvää ä'

Mzüzxfi	7866 k	: 66 k	786 k	: 6 k
Sz³v ffi±³Q	966² k	766² k	96² k	76² k
L fff³fi	966 k	766 k	96 k	76 k
Xv³fi z³Qc ffeQOüfiQ	96² k 58: fl	76² k 58: fl	9² k 58: fl	7² k 58: fl
	766² k 5B666 fl	96² k 5B666 fl	76² k 5B666 fl	9² k 5B666 fl
c ffeQhz² äzüvQ üP³ fff	766² k 576±	96² k 576 ±	76² k 576 ±	9² k 576
hz² äzüvQ üz³ fff	648<+ 576W			
P³ fiv³ fiff fyzüfi³y	H 76 a			

az vffig ff°

Mzüzxfi	8666² L	B66² L	: 66² L	866² L
Sz³v ffi±³Q	: 66 L	7>6 L	B6 L	: 6 L
L fff³fi	<66³L	866³L	766³L	<6³L
Xv³fi z³Qc ffeQgQw³Q	<6 L 58: fl	86 L 58: fl	76 L 58: fl	< L 58: fl
	866 L 5B666 fl	B6 L 5B666 fl	: 6 L 5B666 fl	86 L 5B666 fl
c ffeQhz² äzüvQ üP³ fff	7<6 L 576 W	>6 L 576 W	96 L 576 W	7< L 576 W
hz² äzüvQ üz³ fff	648<+ 576 W			
P³ fiv³ fiff fyzüfi³y	7			

gzä öffiüzfl ä'

kzüfiüfi³ fiffäv³³³ fi	7<k
Sz³v ffi±³Q	648k
a v 4güü²	748L
f v ffliz³	76² k f a g
hz² äzüvQ üz³ fff	86² k 576 W

Näv' 7Qfi flv-5i ° z ä'

L fff³fi	8: 3wQ
l v³yz³üvQ	766 ±T
l v³yz³ züvfliz³	g³fi² v30z³w
L³Q³v³ff³fi Qüü	86 ±T 29ü c ü³³ fi
O³fi³Q³zü Qüü	ü³³Q³² ä 9fe üzffä³ fe .w/zhz ävff²T Üxflävff²M³yävff²M Qüü Üüfi ÜyzüMzfffe°.8³y²: fl2>fi ÜyzüBfi c ü³³ fi/2Rüö z³ wüzxfi 64T wff 76 ±T .äzügÜjQ vüz z³ff²³wüv
a Qü³ züv³y³ fi	±ü³ fi üzüwüÜyzüv Qüü vQffkfi z³ffäüzxfiz³y yzüz³ fizff²³Q³ O³vQ³ üvQ

Xö° ° äffv fää xfiäfl z±ß Qöxv±0 j vffivä z1

düüü±ü²	düüüüzQ üzXüv³w ff.77<866 wäffwff : B a wäff²xvQ³ F 766³ff LgNw 7C866 wäffwff 77<866 wäff a Üyw fff hi düü w fBod .7C866 wäffwff 78 a wäff .ffäz ½² Rü² vüz w³³³ QfiQ
OvQ³ Ü² vQ	BP7
gQ³ yvüy	Lbgshw 5Pw 3 B<3L 283 4ü

effi | gfi füz N9: DAPj

az ° öy ÷ ffyz Oz ff ° ä' öä z ß ffixfizä Zzfl ä' zä

Oz z ß ä' Vjöffi v füzä

Lüzz[®] z z zü mXD>ABB9A gQÜ[®] D>C>: 99 mPD>C><9:

Vertrieb durch



AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de