

g6 w.öä 989j

Qöä ö# Ü...fOQT äµ.öä

g&# ... z|.z|w# ROg5b ä-fl - ö y .:| z| |ä w# W w#w.öä| ä4| µ y | i y w# y äµ | äz
bwä- |... x| wy ä-6g&# 5c | Üöz # x.| |ä.ä | - .|. | i .:..äw#öäz...öä.|. ä- äz w.: Ü| ...y |
T äµ.öä| ä.äÜöz #w| ä4Rw5 y .|,ä| äÜöä .|. xw| äU| | ä4z.| .y |.äfwy wÜÜ| ä |yµ| ä #w | ä
äz öwy |.ä| y |ä| #i |Ü| |..| ä- -wwä .|. |ä6R.| | .x#4z| |ä w# | | .#ä- | #w x z.|
ü ...| äz äy öä...|. |Rw| ä| flw ä- äw| wÜ| # |.#| ä c| ü äµ 6

- hi AEBT| #x 5 y .ä... | # x...: Ac xü Cböywp x... ■ S#µ öÜw-ä| ...y | | | -#y µ| ...-| Ü SdC98885A
99B6 µü Cc özx hj k40i QwW äz SdBB899
- Oä y #. xw vä Qöä ö# .|. #6g6 w.öä4g6w| öz| ■ i üwä ä- | ö - ä- 98 @8l RQ
g#wy ■ Rw5 y .|,ä| äÜöä w-| C8dC8D9B1



Pfi yµ # fiö Sfiw fi

- fiµ müµfiPwfiö wfi x° 877 ÄU ff üZwöwÜ
E awä # 0 awä # ü ö kOhj 1Ü...988 µV 49: E awä # Ü...98 µV
- A= b üz Üi wö yµÜfi xw
AkOhj f6 yöää| y.ä- A 9C ROg Üöz #
- R µfi öfi 4nyµö° fiÜfi Züö B wüö öz Pwfiöw Bwxfi
9U...554j Qf 7M4k Rf4x... 9Cc P7 c özx j Qf 7M40i QwW...: i ü| | z f ö
m| x i | | 4m| x Q#ä äz 55c w#
- SfiÜx 4nyµö° fiÜfi
S .| QQ 5 #w| 498: Al w.w# #ä # | ä äz y | x| ä Ü...98 µV 4
9 Q0d4 ki P: 64x... Ac P7
- Cz#° wÜfi R°B ößfi 6= z#° wÜfi M B ößfi
Säyöz| |.ä-wä- fl y |ä| # .äµ ± äy öä| c| ä- T| ffi| ä 5 äz
f mc 5c | ä-4p . # 4i w .:..äw#
- Pwfiö fffiµµfi z ö5>77 bN fi3 w5=TN fi
| |..| xw x| ki P0x... 9888888c | ä-| ä71 äzi Raw |
- h öyµ üö° wüö öz pfi° h fiä fffiÜfi b fi fi fiö
Ww: xw.|. | c w | 5 #w| f .ä .üw flhi AEBi wäzwz i | Ü
i äy öä..w.öä 9 vä | äzxw
- eMOS öÄ yüöwÜ ä ° fi fiö ° fi N'xÜü µfiÄ
y |ä| # f W5h| -# 40x#w fl | | ä-4Rw| ä#--| 4
x| w- ä- fl äµ.öä| ä4c w- | Üw.µ4Pöö# | µä üfl ä-| ä4
T äµ.öä -| ä| wö | ä

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de



g6 w.öä 989j

Qöä ö# Ü...fOQT äµ.öä

i fiymö° yµfi Pwfiö

c .y. ö Qöä ö#

i ff	∅ fiÜMüä e üyfi ü p><7/8A7 TU 0
hgMb	8TN/>77 b N fi fl βxw fl Pwfiö fffi°yµfi 0
Süvµ	= TN
gfiwÜ° fi ylüyÄ	Nw fi °fi βffff fi
mwyµzüb	e üß wä ä °fi xw
Nfi °fix fiä	gi a°

S · | ä | i y · ä... | #

S wä fi4ß fi	=7DAN fi Pww/879= l w°xÜtiö Üti fiö öz 879= l w°xÜtiö yµ fi°xiö0
Nw z wfi	8Txff
Pwfiö xfi wß öß wfi	8A b N6 ÜtiöÜtiöfi üzfi NlüyÄ wö ffi /<9 l w°xÜtiö xfi°877 ÄU 0
e ü üÄÜÜti	i Oe°k Pe3b üzx i Oe /b w fi öz hÜv fi°MhOV8U°µ hffifiz eü
VüÜv°üö ffwö öß	>77 l PO

S · | QQ | i y · ä... | # 5 |

hffi ° Äw°üö	Ri T9777 R µfi OM hÜv fi ∅fÜ ä w°üö
S wä fi4ß fi	879=x fi /9><l w°xÜtiö Üti fiö öz 9><l w°xÜtiö yµ fi°xiö0
Nw z wfi	877 b xff
p ÄÜ fi°	877
VüÜv°üö ffwö öß	>77 l PO

QOd5 y · ä... | #

Mö wµÜ	8
h wöz wz	OMc 95
Nw z wfi	8b xff
Züö β w°üö	OMc PNOS°ti
OMc 4P	dff °üöwä° k hN4Mz wff fi

c öz # | i y · ä... | # QkOhj 1

Mö wµÜ	= kMgi
Nw z wfi	D9A Äx°ff x° =C b xff /8775/77 b fi ößfiö6 0
b w 5 Üv fi b üz Üti	8A fffi k Mgi
VüÜv°üö ffwö öß	>77 l PO

ki Pi y · ä... | #

Mö wµÜ	9
hffi ° Äw°üö	khN95
Pwfiö xfi wß öß wfi	= b N6 /8b wä ffi°6 0

i R5aw | ä b |

l fi fiöz öß	= b N6 hyö° fiÜti fl Pwfiö fffi°yµfi öß öz S°ä wfi k ffz wfi
--------------	--

g6 w.öä 989j

Qöä ö# Ü...fOQT äµ.öä

R...w# S.ä- ä-|

Mö wµÜ C	
Nfi fix w fiö	h w 3S fi≥ fiö ä fi öβ3p µÜi 3emb b fi öβ3z9° wÜi Röyüzfi fl 6ÄfiÜ öym üöfi b fi öβ
aüßy ffwö öβ	G8I PO/c fizfi 0 I <5>I PO/Uüym0
Röβwöβ ffwö öβ	<7I POä w 5
Röβwöβ üä	85 ä Mä w 5

R...w# O - ä-|

Mö wµÜ =	
S öÄ üö	h w 3mwymzúb öz i ü ä wöö S öÄ üö
M βwöβ ffwö öβ	87 4<7I PO/R fi öfiI fi ü β öβxfiöö 9 0
Züö wÄ	dfffiö P wö ff4zwöwÜb dhSRi
NfiÜw xwÄfi°	<7I PO6877 ä M/üµä yµfi Üw 0

i äy öä...w.öä |.ä| c ±.Qöä ö# i |Ü

e ü üÄüÜ	µVT4N
Tfiöw 9Äfi°	8
h wözwz	Mc hV6 W6RV4=C>4MB94 °fi



I | ö - ä-

I fi ü β öβ ffwö öβ	87 4<7I PO3 xfi ffwö öβ 4 öz I fi ffüÜ öβ yµ
afi° öβ w ffwµä fi	89 m /yWÖ

kÜ-|x ä- x|z.ä- ä-|ä

RÜÄ üä wβöfi ° yµfi fi βÜymÄfi°	fiö ff fiymfiöz WROA87774= öz Rc >>788
Nfi fix fiä ffi w	497 0x° 2A7 0
avβfi fiä ffi w	4=7 0x° 2C> 0
gfiÜw° fi Üfi ffi yµ 9Äfi°	>4D>, xfi°>7 0/ö°ym Äüözfiö fi fiöz0

T äµ.öä R.w wÜÜ

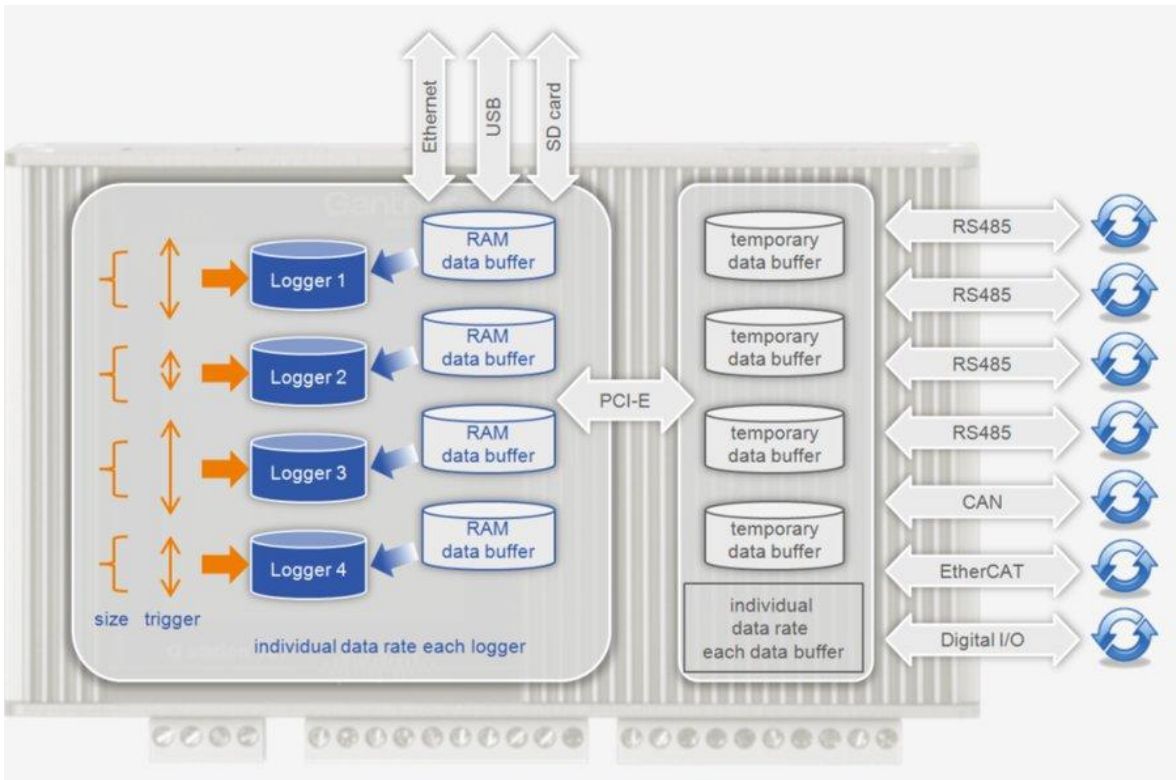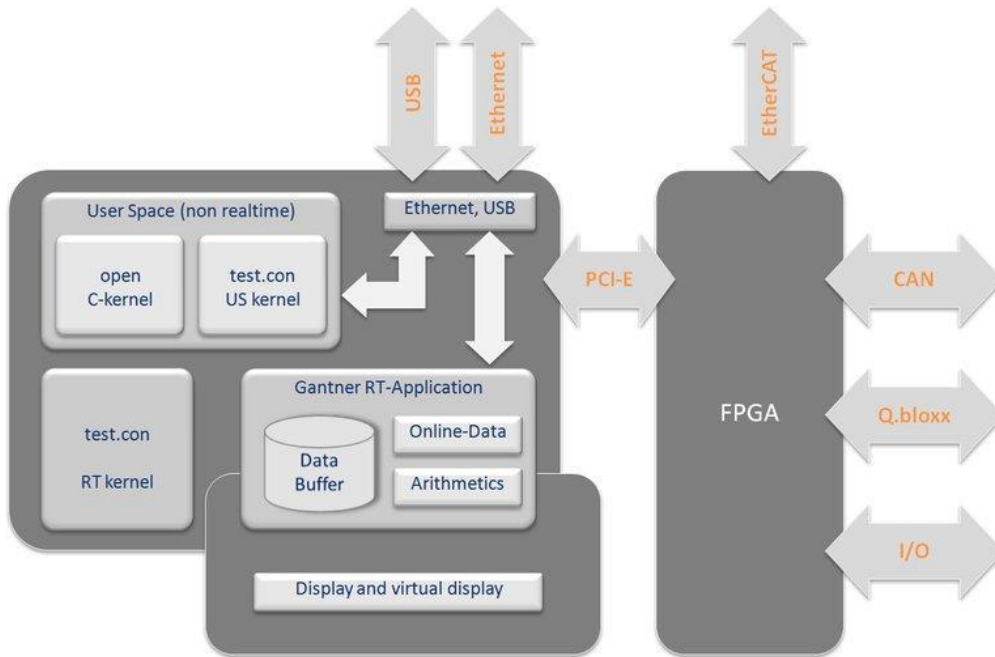

g6 w.öä 989j

Qöä ö# Ü...fOQ5T äµ.öä

i öfl w| Ozz5eä

b wÜx	I fi fl Bxw fl <96A=4° I fi Üöfiö3g°ß ffi'yµfi w Üi fiö
Pw awk	S Pw awk I fi Üöfiö I H8>3g°ß ffi'yµfi w Üi fiö3afi fiöthyµ fi'xfiö üö döÜöfi mfi fiö
avkl 'fi	S I fi Üöfiö I H978A/ Üfi fi I fi Üö ffi c wyµfl wßfiß I fi fl Bxw ° <96A=4° 3g°ß ffi'yµfi w Üi fiö3afi fiöthyµ fi'xfiö üö döÜöfi mfi fiö
fi 5yüö	Röflwyµfiß w yµfi e üß wä ä 'fi öß fl Rzßfi4Üä ff °ß4Tfi fi

f ± -5ä

I fi fl Bxwfi eÜß4° xfiöö 'ßfiö TVÜ üö ü fl zfi Züö ß w'üö3M ßwöß zwfiö Ä ööfiö w üä w° yµ wö z'fi Äüö ß 'fi fiö Rà ffi ößfi ßfi fiözfi fi zfiö

g wö ü	p ÄÜ µÜiözfi MÜü mü g wö ü UOb fiö ff fiyµfiöz Üüü ä wö hfißfi ä ° b w ° ° 5y Sü ä w
SSi	S fi z fiö MßwÜ fi ä ° µÜwfiä Sfiö fi b üz 3S fi z fiö xfi fi'yµ öz Mö wµÜ üö x'° /M öß0 ä ° M ßwxi ° 5y Sü ä w

c | y· vä...y· | Wfö Üw.öä| ä

b wfi wÜ	MÜ ä ° ä
Mxä fi ößfiö /N U i O	8B> 887 >> ä ä
Tfi 'yµ	ywßD77 ß

P| | ± ä- Wfö Üw.öä| ä

M 'ÄfiÜ ä ä fi	=A>79B
p xfiµ	TVÜfiöyµ3w 'yÜiö ä xfi 4
	TVÜü z3w 'yÜiö ä xfi 4

Vertrieb durch

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de