

Q.bloxx XE A127 SEB

Messmodul für die Bestimmung von elektrischen Leistungen

Q.bloxx XE – ein neues Mitglied der Q.serie – ist die ideale EtherCAT-DAQ-Lösung für großflächige dezentrale Installationen, die nach Hochleistungs-Messmodulen und kundenspezifischen Sensoranschlüssen verlangen. Q.bloxx XE-Messmodule bieten integrierte Signalkonditionierung und arithmetische Funktionen in modularen, DIN-schienenmontierbaren Gehäusen. Für die Systemerweiterung lassen sich die Module einfach zusammenklicken. Q.bloxx XE-Module bieten Messgeschwindigkeiten von bis zu 100 kHz pro Kanal, kurze Taktzeiten, geringen Jitter und eine präzise Synchronisation.

- RS-485, 2-Leiter, EtherCAT (LVDS)
- FoE (file access over EtherCAT, ETG.1000.5) und CoE (CAN over EtherCAT, ETG.50001.1)
- Kofigurierbares PDO-Mapping zur Optimierung des Datendurchsatzes
- Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN61000-4 und EN55011
- Versorgung 10 ... 30 VDC und DIN Tragschienenmontage gemäß EN 60715



Die wichtigsten Features


- **4 Spannungseingänge**
2 Eingänge zur Spannungsmessung
Messbereiche $\pm 40\text{ V}$, $\pm 120\text{ V}$, $\pm 400\text{ V}$, $\pm 1200\text{ V}$
2 Eingänge zur Strommessung über einen Shunt
Messbereiche $\pm 80\text{ mV}$, $\pm 240\text{ mV}$, $\pm 800\text{ mV}$, $\pm 2400\text{ mV}$
- **Signalkonditionierung**
Digitales Filter, Mittelwert, Skalierung, Min-/Max-Speicher, Effektivwert, Alarm
- **Schnelle hochauflösende Digitalisierung**
24 bit ADU, 100 kHz Abtastrate pro Kanal
- **Galvanische Trennung**
Kanal zu Kanal zur Versorgung zur Schnittstelle
Isolationsspannung 1200 VDC / 848 VACrms permanent
Testspannung 5 kVDC über 1 Minute
- **Kategorien**
1000 V CAT II und 600 V CAT III

Vertrieb durch



AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz


Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

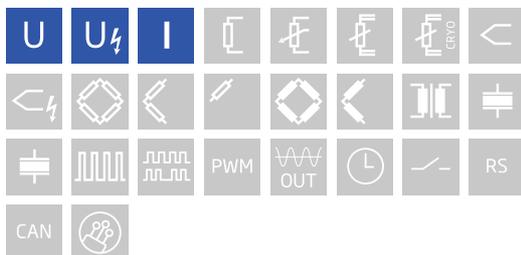

Q.bloxx XE A127 SEB


Messmodul für die Bestimmung von elektrischen Leistungen

Blockdiagramm

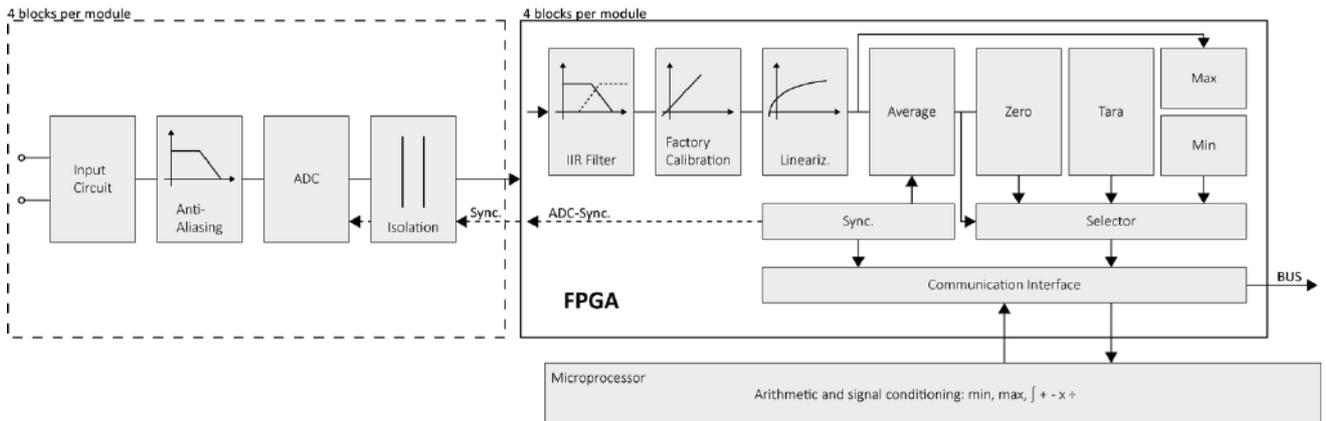

Technische Daten

Anschlussbelegung Hochspannungs Bananen Buchsen

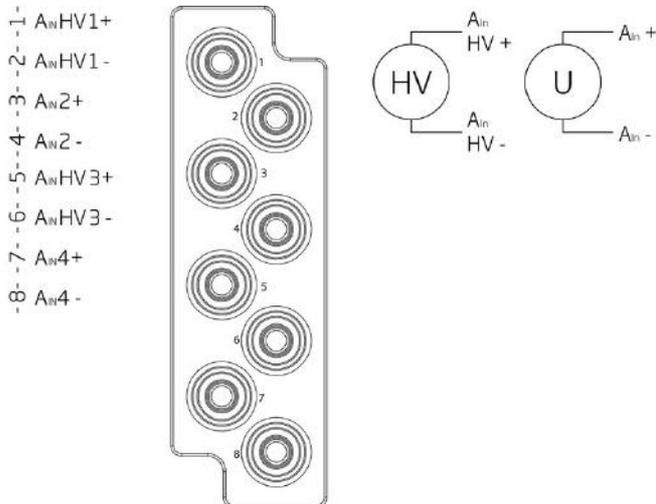

Analoge Eingänge

Anzahl	4
Genauigkeit	0.01 % typisch
	0.025 % in beherrschter magnetischer Umgebung ¹
	0.05 % im industriellen Bereich ²
Linearitätsabweichung	0.01 % vom Endwert typisch
Wiederholpräzision	0.003 % typisch (innerhalb 24 h)
Isolationsspannung	1200 VDC dauerhaft, Kanal zu Kanal zur Spannungsversorgung zur Schnittstelle ³

¹ entsprechend EN 61326 2006: Ergänzung B

² entsprechend EN 61326 2006: Ergänzung A

³ Hochspannung lebensdauer (TDD B E Model). Zeit bis zu einem möglichen fehler ca.. 4 jahre bei 1200 VDC und 60 °C dauerhaft

Q.bloxx XE A127 SEB

Messmodul für die Bestimmung von elektrischen Leistungen

Messart Spannung AI1 + AI3

Bereich	± 1200 V	± 400 V	± 120 V	± 40 V
Genauigkeit	± 300 mV	± 100 mV	± 30 mV	± 10 mV
Auflösung	300 µV	100 µV	30 µV	10 µV
Langzeit Offset Drift	30 mV / 24 h	10 mV / 24 h	3 mV / 24 h	1 mV / 24 h
	100 mV / 8000 h	30 mV / 8000 h	10 mV / 8000 h	3 mV / 8000 h
Offset Temperatur Einfluss	100 mV / 10k	30 mV / 10 k	10 mV / 10 k	3 mV / 10
Temperatureinfluss	0.025 % / 10K			
Eingangswiderstand	> 10 MΩ			

Messart Spannung AI2 + AI4

Bereich	± 2.4 V	± 800 mV	± 240 mV	± 80 mV
Genauigkeit	± 600 µV	± 200 µV	± 60 µV	± 20 µV
Auflösung	600 nV	200 nV	60 nV	20 nV
Langzeit Offset Drift	60 µV / 24 h	20 µV / 24 h	6 µV / 24 h	2 µV / 24 h
	200 µV / 8000 h	60 µV / 8000 h	20 µV / 8000 h	10 µV / 8000 h
Offset Temperatur Einfluss	200 µV / 10k	60 µV / 10 k	20 µV / 10 k	10 µV / 10 k
Temperatureinfluss	0.025 % / 10K			
Eingangswiderstand	> 100 MΩ			

Messart Strom

	Bereich	max. Abweichung	Auflösung
Via Shunt Kanal 2 und 4	±2400 mV	±600 µV	600 nV
	±800 mV	±200 µV	200 nV
	±240 mV	±60 µV	60 nV
	±80 mV	±20 µV	20 nV
Langzeitdrift	<20 µV / 24 h	<200 µV / 8000 h	
Temperatureinfluss	Auf Nullpunkt	Auf Messempfindlichkeit	
	<50 µV / 10 K	<0.02 % / 10 K	

Analog/Digital-Umsetzung

Auflösung	24-bit
Wandelrate	100 kHz
Wandelverfahren	Sigma-Delta
Anti-aliasing filter	20 kHz, 3rd Ordnung
Digitaler filter	Infinite impulse response (IIR), Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Butterworth oder Bessel (2nd, 4th, 6th oder 8th Ordnung), Frequenzbereich 0.1 Hz bis zu 10 kHz (per Software einstellbar)
Mittelwertbildung	konfigurierbar oder automatisch entsprechend der eingestellten Datenrate

Kommunikationsschnittstelle EtherCAT

Standard	RS-485, 2-Leiter
Protokolle	EtherCAT (LVDS)

Q.bloxx XE A127 SEB

Messmodul für die Bestimmung von elektrischen Leistungen

Versorgung

Versorgungsspannung	10 bis zu 30 VDC, Überspannungs- und Verpolungsschutz
Leistungsaufnahme	ca.. 2 W
Spannungseinfluss	< 0.001 %/V


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C bis zu +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis zu +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis zu 95 % bei 50°C, nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad	1

Gültigkeit der Angaben

Aufwärmzeit	Alle Angaben sind gültig nach einer Aufwärmzeit von 45 Minuten
	Technische Änderungen vorbehalten

Hochspannungs Warnungen



- Vorsicht Hochspannungsmodul, Gefahr für Leben und Gesundheit bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Module dürfen nur durch hierfür geschultes Personal in Betrieb genommen werden.
- Alle Gehäuseteile aus Metall müssen sicher und dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein (PE)
- Es dürfen nur Stecker und Kabel mit Berührungsschutz verwendet werden. Bauteile benötigen eine zugelassene Spannung von 1200 VDC.
- Während der Installation, muss das komplette System spannungslos und sicher vom Netz getrennt sein.
- Alle einschlägigen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

Basis ist der Europäische Standard EN61010-1

Mechanische Informationen

Material	Aluminium und ABS
Abmessungen (B x H x T)	30x 145 x 160mm
Gewicht	ca. 500 g

Bestellungs Informationen

Artikelnummer	567632
---------------	--------

Vertrieb durch 

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de