

c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß ffifiy eäu±± ±j y±

c 5.Ü k P yfè±y yffX fl .fyxxyüç 5fiyü fiifi xfy fkyu.y P fiyüNlf 40Lc 4W ffi ±j z üj üj wifl y xy y± ü.y Tffiu.u flü±y±x fy ±uwi S Üwi.y ffi ±j ffx yffmß Üx .y± ±x· ±xy±ffay fl ffifiy±ey±f lüü±ffwi...ffifi± yüu±j y±5 c 5.Ü k P 4Xyffmß Üx .y.vfy y± fè yj üyü y efl ±u..Ü±x fl flü±fyü ±j ±x uüfiß y ffifiy Q ± flü±y± fèß Üx .uü±± OT 4ffifiy±y±ß Ü± fyüüü±Ryfi ffy±5Q üx fy e ffiyß yü yflyü ±j .uffifi± ffifi xfy XÜx .y.yfè±uwi ffüß y± .ffwy±5c 5.Ü k P 4X Üx .y.vfy y± Xyffmß yffwi fèx fl .yfly± Ü±vffi 877·S äüV u±u.3 ü y fu yfly±±j yüfèj y±fèj yü ±x yfèy äü ffifi e ±vfiü±ffü flü±5

- de4<C@394yflyüP fiyüNlf /M0e0
- QÜP / .y.uwyffifiü yüP fiyüNlf 3Pf R57750 ±x NÜP /NLZ Ü yüP fiyüNlf 3Pf R577850
- VÜ | üfyüuüüffibOa 4Xuääfèj üä ä fèß fyü ±j xyffi Ou y±x üvffü yffi
- P.y. üß u| ±y ffifiy hyüü | .ffwi yfl | yß PZA87774< ±x PZ@@788
- hyüfèü ±j 87 : 7 hON ±x OT fèü ffifiy±y±ß Ü± u| y | yß PZ A7B8@



SÄj ÄP Ä pffUuz µ


- >°zö zffÄ ff° µ pffff µ TÄP° zff° äzff ü eäu±± ±j y±3Myüfiy 877 h3 : 77 h3 A77 h3 8@77 h
- I Ä ffaüff° ÄÄffü ff° wfyüffüü ±j 3x fl flu.yffQfl.yüBX fl y...yü 3e· u.fyü ±j 3X fèß Xu 4äyffiyüß dXeß üfiß y fl 3L.uüß
- WÖP z µffµ SÄ ÄzÄÄj ff° 9< vfl LOg3877·S Lv uffüü y äüV u±u...
- Vzö zffÄ ff° µ pffff ff° Vu±u... Vu±u... ühyüfèü ±j üewfi±fl ffiy..y Tfèü flü±ffüu±± ±j 8@77 hON 8777 hNLÜß ffäyüß u±y± fyffiffüu±± ±j @· hON vyü8X fè y
- cz µ°Ω Äjff A77 h Nlf Tt68777 h Nlf Tt68@77 h Üfi±y Nlf

Vertrieb durch



AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz


Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

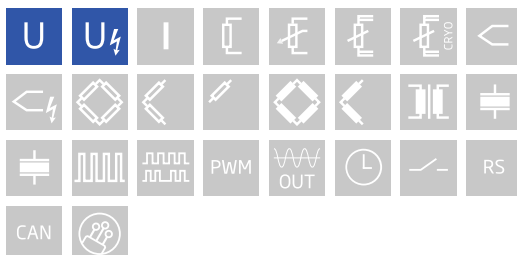

c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM


Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß ffffiy eäu±± ±| y±

Pöfä¹ Ä° zü ü

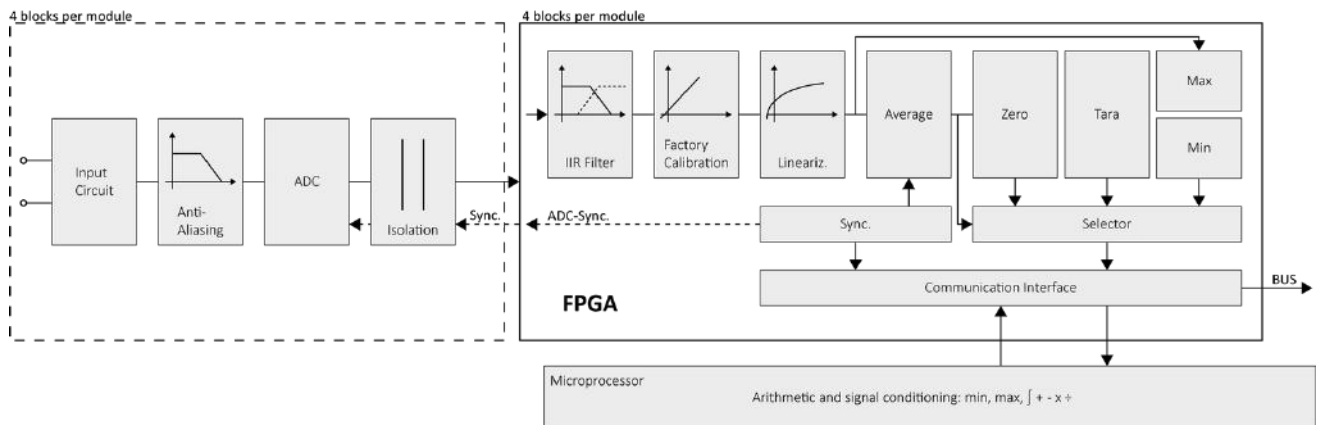

mpff ffÄ ff µ Sz µff

L ±fffi...fffiy.y| ±| S Üwiffäü±± ±| ffMu±u±y±M wiffy±

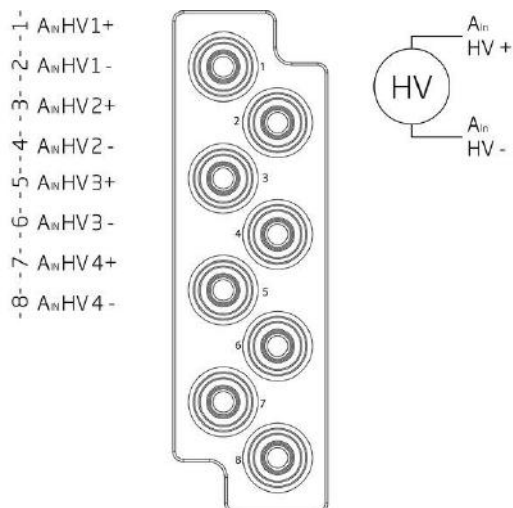

L ±u.Ü| y Pff| ±| y

Off z ² ö >	
Vµffz Ä äµÄ	758, Ä ff
	759A, Äffµ²µ ff µ ü z°ffµ Äffµ n ü °µfi ff
	75A, Ä Ä ff ÄüffPµ µÄP
dÄffµz Ä zfi µÄP ff	758, Qü Tff µ Ä ff
p Äµ¹µ²Qö ÄÄff	757<, Ä ff /Äffµ²zöi9>²0
aQz Äff zffff ff	8A77 oSR¹z µ²z±³czffzö czffzö zffff ff µ Q° ff ff ffÄ µäµ

8 y± fffüwfiy±x PZ AB 9A977AEP| ± ±| M

9 y± fffüwfiy±x PZ AB 9A977AEP| ± ±| L

c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß ffifiy eäu±± ±| y±

Xyffmüü eäu±± ±|

Pµ µÄP	8A77 o	B77 o	<77 o	877 o
Vµffz Ä äµÄ	<77 ü o	897 ü o	B7 ü o	97 ü o
O ff	<B7 o	8A7 o	CA o	9A o
dzff µÄ g µ S Ä	<7 ü o 69>²	89 ü o 69>²	B ü o 69>²	9 ü o 69>²
	<77 ü o 6D777²	897 ü o 6D777²	B7 ü o 6D777²	97 ü o 6D777²
g µ mü µ z TÄf	877 ü o 687ä	>7 ü o 687 ä	97 ü o 687 ä	C ü o 687 ä
mü µ z µÄf	759A, 687c			
TÄP zff Äµ zff	K 87 e			

L ±u.Ü| 60fl flu.4g B ffy ±|

O ff	9>4fiÄ
p zff µöz µ	877 äW
p zff µö µ ±² µff	l Ä ü z45µöz
Off ÄzÄ ÄP öµ	97 äW 3<¹ g¹ ff ff
SÄ Äzqµ öµ	ff ffÄµ Äi öµ µ Qff µ/akOmÄ± z 3WQff z 3Pzff z 3P µ Ω² Ω¹ µ Pµ µö/9ff 3>² 3B² Ω¹ µ D² g¹ ff ffCBU µ µff fiµ µÄP 75B W fiÄ 87 äW / µ l Ω± z µµÄf µäfiz 0
e Ä µö µ fiÄ ff	äQff ° Äi fiz Ω¹ µ z Ωü z Äff µff µff µff¹ µ µÄP µ µöµffSz µff z µ

VÜB B ±fi u flü±ffmfi±fi ffy..y P fiyÜLf

l zff z¹	kl 4DA394lµÄµ
h Ω QäQµ	T² µ R0m/doSI 0

hyüffü ±|

oµ Ω° ff zfff ff	87 fiÄ <7 oSR3 fiµ zfff ff 4 ff oµ Qö ff ff
dµÄ ff z ffz² ü µ	flz5<p
l zfff ff µÄf	H7578, 6o

gB| yv ±| ffyxfl ±| y±

Pµ Äfi mü µ z	4B7 RfiÄ 2B7 R
dz°µ mü µ z	47 RfiÄ 2DA R
kµö Äµd ±µ ff Ä äµÄ	A, fiÄ EA, fiµÄA7 R3ffÄP äQff µff Äi µff
oµ ffü ff ° z¹	9

R ...fl · yfi xyÜL ±| uvy±

O ± ü µÄ	OäµOffP zfiµff ÄP ° öÄ ffzff µÄfiµ O ± ü µÄ Qff>AeÄf µff
	µuffP ffÄff µ ff µ ff µff Ω fiµ² zöµff

c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uB fffwfiy eäu±± ±| y±

SÜwiffäü±± ±| ffi uü± ±| y±



4hÜüfwi SÜwiffäü±± ±| ffi Üx .3Ryzufiüz üwvy± ±x Ryffi ±xfiyfl vyfl ±ffüwfi| yß yß Ryvü wfi5
4XÜx .y.x üy±± üx üfi fiyüz ü| yffwi ..yffäyüffü±u..ff vy üfyv | y±Üß B y± yüky±5
4L..y Ryfi ff yfly u ffXy u...B fffiy±ffwfiyü ±x xu yüfiuz B fl xyß ewfi .y.flyü yüv ±xy±ffiy fl/bP0
4Pffz üy±± üffiywyü ±x·uvy..B fl vyü fiü ±| fffwi yü y±xy yüky±5Mu yfly vy±± fl y±yfly
| y.uffiy±y ffäü±± ±| Ü±8@77 hON5
4i fiy±xxyüffü..u flÜ±3B fffixuffi Üß ä.y y e ffiyß ffäü±± ±| ffÜffi ±x fffwfiyü Üß Zy | y üy±± ffiy fl5
4L..y y flffwi...| fl y± fffwfiyüfiyflffiy| y.± ffflx vyuwfi y±5
4m ...ffü| y Xyffmß fffiyß yER.y.fwiffäü±± ±| vffi 8@77 h3ffl ffä üß fl y i ywiffy.fffäü±± ±| /G: 7·S Ovffi
8777 h5
4±ffwi B fl vyffwi xfl yügß fi±| vy üfyv±5
4Xyffmß fl ±u.B fffü zyfly B u flB u.y vyüffäü±± ±| Ü±A·h vyffwiü ±y± yüky± B ü±ffiy±y
vyüffäü±± ±| y± vy| üy± y±

Muffmß xyüP üä fffiy e u±xuü PZA87874B- PZ PNA87874B47: 7

Xywiu±ffwfiy TzÜÜß u flÜ±y±

e z µ Äö	Oö ü ÄfÄ ü ff OPI
Ofiü µ ff µff/P W mD	<7 8>A 8<Aü ü
Vµ ÄP	flz5A77 °
I ff äz µ	h97

Xywiu±ffwfiy TzÜÜß u flÜ±y±

e z µ Äö	Oö ü ÄfÄ ü ff OPI
Ofiü µ ff µff/P W mD	<7 8>A 8B7ü ü
Vµ ÄP	flz5A77 °
I ff äz µ	h97

Myffiy....±| fffTzÜÜß u flÜ±y±

O Äµff ü ü µ	C<C79A
--------------	--------

Vertrieb durch **AMC**

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de